




6.1.2 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

UBICACIÓN


El servicio se encuentra ubicado en la **Planta Baja del BMI**

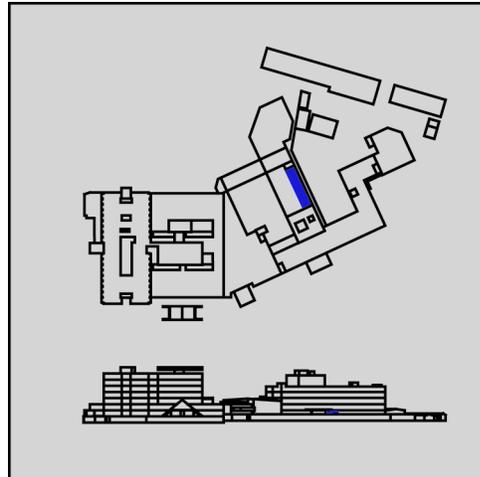

AREAS FUNCIONALES

Esta conformado por los siguientes ambientes: Servicios Sanitarios, Estación de Enfermería, Área de Observación con cuatro camas. Los espacios destinados para estancia de enfermeras y aislados son utilizados como depósito de materiales y equipos.

•Los cuadros ubicados en la parte inferior izquierda de la columna de elementos contienen los números correspondientes a las recomendaciones especificadas en el capítulo 8.



Fecha de la evaluación: del 12 de Julio al 8 de Agosto del 2002



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>1. Cielos Falsos</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	4				 <p style="text-align: right;">Foto 1</p>	<p>Los Cielos falsos del servicio fueron reemplazados en la remodelación y se encuentran en buen estado.</p> <p>Foto1 Por falla del sistema de soporte o por deformación se puede producir la caída de los paneles sobre las personas y equipos, puede provocar la obstrucción de la circulación y principalmente pánico en los ocupantes del servicio.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
4						
<p>2. Puertas</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> </table>	2	3	6		 <p style="text-align: right;">Foto 2</p>	<p>El servicio cuenta con puertas de madera, algunas con visillo (ventanas pequeñas) Foto2. Estas puertas no presentan ningún riesgo por su material y el tamaño de sus vidrios</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Bajo Riesgo de Pérdida del Bien</p>
2	3					
6						
<p>3. Ventanas</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	3	2			 <p style="text-align: right;">Foto 3</p>	<p>El servicio posee ventanas, altas, con marcos de aluminio y vidrio Foto3. Algunas de ellas ubicadas sobre camillas de pacientes. En caso de un sismo los vidrios de las ventanas se pueden romper por deformación impuesta en su soporte (marco), ocasionando daño a las personas y obstruyendo las circulaciones.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
3	2					



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>4. Sistemas de iluminación</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>5</td> <td>8A</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	5	8A			<p style="text-align: right;">Foto 4</p>	<p>El servicio cuenta con lámparas fluorescentes empotradas en el cielo falso Foto4 y lámparas incandescentes. Todas las lámparas fluorescentes presentan acrílicos protegiendo los tubos y todas se encuentran operativas .</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
5	8A					
<p>5. Enchapes y revestimientos</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>7</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	7				<p style="text-align: right;">Foto 5</p>	<p>Todo el servicio presenta enchape cerámico, de 10 x 10 cm. Foto5 En el caso de circulaciones a media altura y en áreas de procedimientos de piso a techo. Como consecuencia de un sismo es posible que las paredes del edificio sufran deformaciones y que esto provoque el desprendimiento de algunas piezas, causando obstrucción del paso, posible daño a las personas y equipos y sobre todo ocasionando confusión y pánico en las personas.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
7						
<p>6. Otros elementos</p> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>1</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	1				<p style="text-align: right;">Foto 6</p>	<p>Se observa la existencia de una junta constructiva en el servicio, esta junta no posee un tapa junta o dispositivo para protegerla Foto 6. A excepción del falso cielo no hay mas elementos rígidos ubicados en el área.</p> <p>Bajo Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Bajo Riesgo de Pérdida del Bien</p>
1						



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS						
ELEMENTOS	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>1. Bombas de Infusión</p> <table border="1" data-bbox="245 863 329 940"> <tr> <td>11C</td> <td>11A</td> </tr> <tr> <td>11B</td> <td></td> </tr> </table>	11C	11A	11B		 <p>Foto 7</p>	<p>Bombas de infusión, Respiradores mecánicos y otros equipos médicos portátiles indispensables para el soporte de la vida que posean ruedas sin frenos o algún sistema de sujeción pueden desplazarse y quedar desconectados del paciente y de la fuente de energía, quedar inoperativos poniendo en riesgo la vida del paciente. Foto 7 Chocar con otros elementos y/o personas causándoles daño y obstruir la circulación.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11C	11A					
11B						
<p>2. Equipo sobre Muebles</p> <table border="1" data-bbox="245 1367 329 1444"> <tr> <td>11A</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	11A	10			 <p>Foto 8</p>	<p>Monitores y otros equipos simplemente apoyados sobre mesas sin poseer un sistema de sujeción a mueble Foto8. Pueden sufrir un desplazamiento o caída y quedar desconectados del paciente, de la fuente de energía, quedar inoperativos y poner en riesgo la vida del paciente. a la fuente de poder o al paciente y posiblemente un daño interno dejándolo inoperativo.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11A	10					
<p>3. equipo y/o Elementos cerca de Pacientes</p> <table border="1" data-bbox="245 1812 329 1890"> <tr> <td>11C</td> <td>11A</td> </tr> <tr> <td>12C</td> <td>10</td> </tr> </table>	11C	11A	12C	10	 <p>Foto 9</p>	<p>Bombas de infusión, cilindros de oxígeno y otros elementos ubicados cerca de pacientes sin un sistema de sujeción pueden desplazarse y sufrir desconexión, pueden caer, ocasionando daño a los pacientes o al personal, sufrir un daño interno quedando inoperativos Foto 9. En el caso de los cilindros éstos pueden caer liberando su contenido. Las camillas si tienen un sistema de freno en las ruedas para evitar el desplazamiento de las mismas.</p> <p>Alto Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11C	11A					
12C	10					



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS						
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES				
<p>4. Refrigeradoras</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>8</td><td>11F</td></tr> <tr><td>11B</td><td>10</td></tr> </table>	8	11F	11B	10	 <p style="text-align: right;">Foto 10</p>	<p>Una refrigeradora u otro equipo apoyado en el piso sin un sistema de sujeción Foto10, puede sufrir desplazamiento, choque con otros elementos o caída y como consecuencia sufrir un daño interno, desconexión, perder su contenido y bloquear rutas de evacuación, causar daño a personas y/o otros equipos. Dado el caso de poseer elementos apoyados sobre ella Foto , estos también pueden sufrir las mismas consecuencias del equipo.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
8	11F					
11B	10					
<p>5. Almacenaje de Equipos</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>11B</td><td>11A</td></tr> <tr><td>12A</td><td>12B</td></tr> </table>	11B	11A	12A	12B	 <p style="text-align: right;">Foto 11</p>	<p>Equipos y otros elementos almacenados sin estar clasificados y sujetos Foto11, pueden sufrir desplazamiento, caída, choque entre ellos mismos y como consecuencia ocasionar daño a personas y equipos, sufrir daños, y probablemente dejar inaccesible el espacio.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11B	11A					
12A	12B					
<p>6. Equipo y Mobiliario en Áreas de Trabajo</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <tr><td>11A</td><td>11C</td></tr> <tr><td>11D</td><td>11F</td></tr> </table>	11A	11C	11D	11F	 <p style="text-align: right;">Foto 12</p>	<p>Equipos médicos y mobiliario portátil ubicados en áreas de trabajo y circulación están provocando obstrucción de la misma en el funcionamiento normal del servicio Foto12. En caso de un desastre al no estar frenados o apoyados en las paredes sufrirán desplazamiento, choque entre otros elementos y las personas ocasionando daños, confusión y pánico.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Alto Riesgo de Pérdida Funcional Alto Riesgo de Pérdida del Bien</p>
11A	11C					
11D	11F					



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS U.C.I. PEDIATRICA

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELANEOS		
ELEMENTO	ILUSTRACIONES	SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES
<p>7. Mobiliario en general</p> <p>1B 11D 11E 11F</p>	<p>Foto 13</p>	<p>Los estantes, mesas y demás muebles sin sujeción presentan una gran facilidad de desplazamiento, lo que hace susceptibles a los elementos que se hallen ubicados en ellos, se debe prestar especial atención a lo ubicado en la parte superior de los mueble altos y que no cuentan con dispositivos de protección y que en caso de falla de la estabilidad del mueble se podría producir la pérdida del elemento en el ubicado y obstrucción de la circulación. Foto13</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Mediano Riesgo de Pérdida del Bien</p>
<p>8. Muebles altos</p> <p>11C 11B 11A</p>	<p>Foto 14</p>	<p>Lockers, muebles y elementos altos, sin sistemas de sujeción, ubicados en zonas de circulación son elementos peligrosos para las personas Foto14. Estos elementos pueden sufrir desplazamiento o caída y como consecuencia causar daño a personas y/o equipos y obstruir la circulación.</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Mediano Riesgo de Pérdida Funcional Bajo Riesgo de Pérdida del bien.</p>
<p>9. Adornos y elementos colgantes</p> <p>8A 9 11A 11E</p>	<p>Foto 15</p>	<p>Adornos y otros elementos ubicados sobre las camas pueden caer y causar daño a los pacientes. Foto 15</p> <p>Mediano Riesgo para la Vida Bajo Riesgo de Pérdida Funcional Bajo Riesgo de Pérdida del bien.</p>